FAUTEUIL D'EVACUATION code FAUVAC
Notice d'utilisation

Fig1

Comment ouvrir le fauteuil?
Quand le fauteuil est plié (fig 1), tenir simultanément les 2 points A et B et écarter les pour arriver dans la configuration ouverte (Fig. 2)

Fig2

Comment préparer le transport du patient ?

Une fois que le patient est bien assis, baisser les 2 accoudoirs en appuyant sur les parties terminales des poignées en plastique noir comme en (fig. 3). Pour placer les poignées arrières en position horizontale, les tirer vers le haut.
Pour mettre en place les poignées de portage avant, pousser jusqu'au clic de verrouillage. (fig. 4)
Les poignées de portage avant peuvent être allongées en appuyant sur le bouton poussoir et en tirant vers vous en même temps. Vous aurez alors le fauteuil en configuration selon (fig. 2).

Fig3

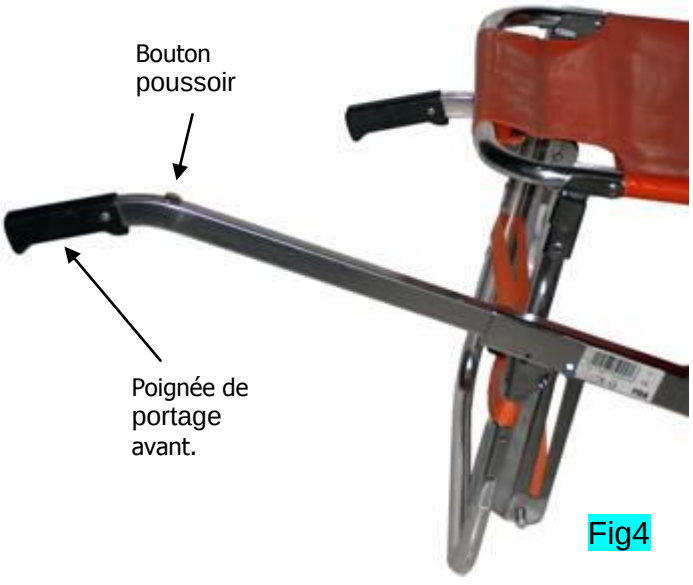

Fig4

SYSTEME DE SECURITE
Pour une meilleure stabilité quand le fauteuil est ouvert, la roue gauche peut être verrouillée (fig. 5) en pressant du pied sur le point A.
Pour déverrouiller, presser sur le point B.
Pour mettre la poignée de portage avant dans la même position qu'en configuration plié, tirer le système de verrouillage en (fig. 6) vers vous, libérant l'axe. Remonter alors la poignée de portage avant.
Des ceintures de maintien à fermeture rapide sont livrées avec le fauteuil pour une sécurité du patient accrue : il est impératif de les utiliser.

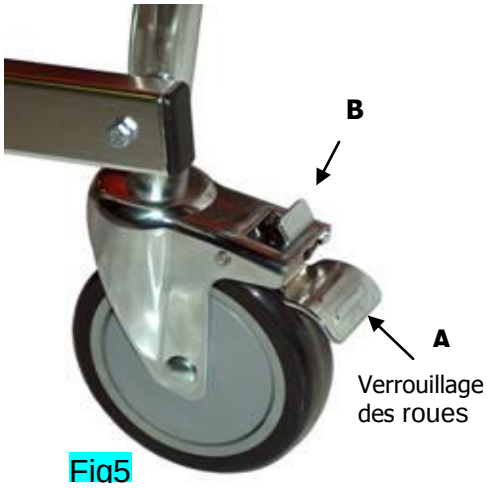

Fig5

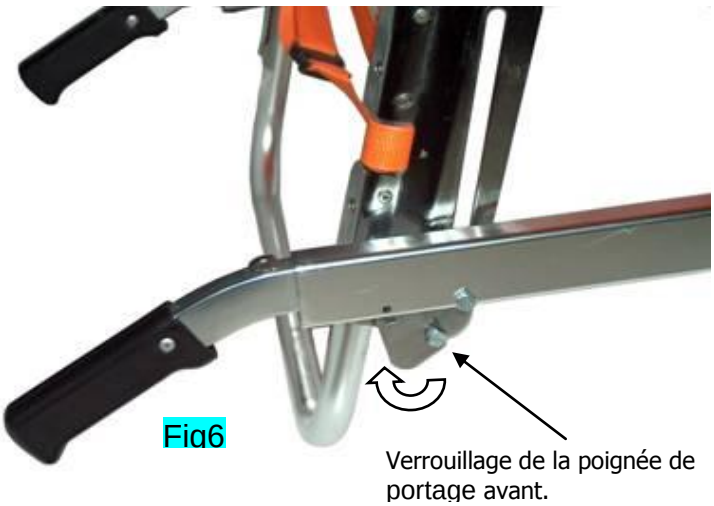

Fig6

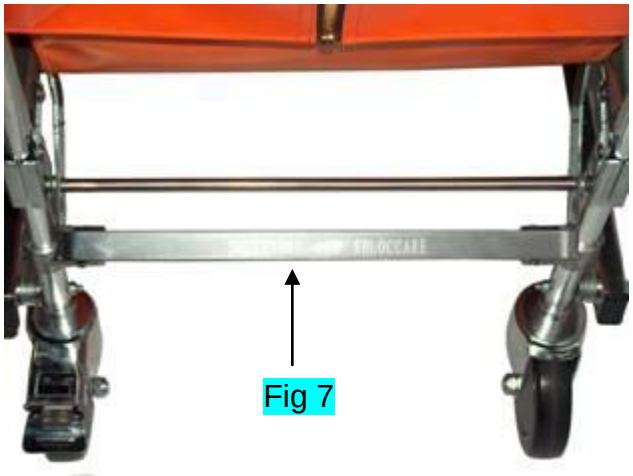
Fig 7

Comment plier le fauteuil?

Remettre toutes les poignées dans leur position initiale. Avec une main tirer la barre en (fig. 7). Avec l'autre main, tirer le châssis de la chaise au maximum : la chaise sera alors en configuration (fig. 1)
Pour plus de sécurité, le fauteuil est livré avec une sangle pour éviter toute ouverture intempestive.

Conseil de stockage
A nettoyer avec un produit nettoyant-désinfectant entre chaque usage.
Stocker dans un endroit propre et sec, à l'écart de toute source de chaleur.

Dimensions (en mm) :
Plié : H 910 x P 195 x L 520
Ouvert : H 910 x P 710 x L 520
Poids : 8,50 Kg.
Charge maximum : 150 Kg.

CE